



产品规格书 Product Details Specification

Product Description	Revision	Release Date	Page
FR-23HD5	A 1	2023.08.10	1/5

■ 产品概述

FR-23HD5是一款基于激光散射原理设计的数字式颗粒物检测传感器，可实时检测当前颗粒物浓度，可测试颗粒物的范围从 $0.3\mu\text{m}$ 至 $10\mu\text{m}$ ，可提供多种不同的数字输出接口，独有开机自校准功能。传感器由一个激光发射模组和一个光线检测镜头，十字交叉的放置于结构内部，内置直流风扇，提供稳定的气流，采用长寿命激光光源。本传感器具有良好的的一致性、稳定性，体积小，便于集成。本传感器可嵌入各种与颗粒物浓度相关的仪器仪表或设备中为其提供及时准确的数据。

■ 主要特性

- ✦ 激光散射原理实现精准测量
- ✦ 实时响应并支持连续采集
- ✦ 最小分辨粒径 $0.3\mu\text{m}$
- ✦ 采用双频数据采集技术
- ✦ 独有激光自校准技术
- ✦ 超薄型， $49*31.5*10.8\text{mm}$
- ✦ 金属屏蔽外壳，抗干扰性能好
- ✦ 可定制风口方向，适用范围广
- ✦ 标准串口数字输出并支持 PWM 脉宽输出



■ 工作原理

本传感器采用激光散射原理,空气通过测量腔体时空气中的悬浮颗粒物使激光产生散射,在特定角度收集激光散射光,得到散射光强随时间变化的曲线,微处理器根据米氏(MIE)理论,计算出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。传感器各功能部分框图如图所示。

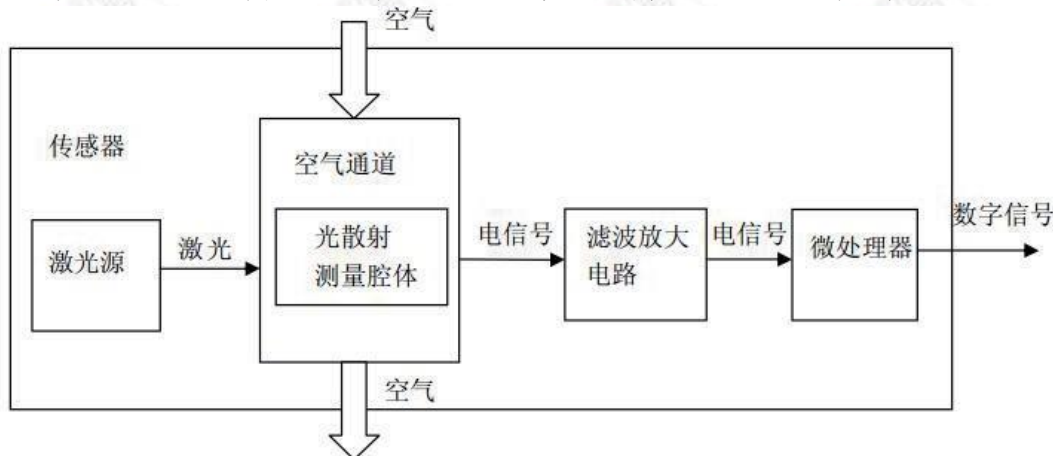


图 1 传感器功能框图



东莞富锐仕电子科技有限公司

Dongguan Forest Electronic Technology CO.,LTD.



产品规格书 Product Details Specification

Product Description	Revision	Release Date	Page
FR-23HD5	A 1	2023.08.10	2/5

■ 技术指标

参数	最小	典型	最大	单位
测量范围	0.3	2.5	10	μ m 微米
颗粒物质量浓度有效量程	0	700	-	μ g/m3 微克/立方米
颗粒物浓度最大量程	≥1000			μ g/m3 微克/立方米
颗粒物质量浓度分辨率	-	1	-	μ g/m3 微克/立方米
称准体积	-	0.1	-	L 升
颗粒物数量量程	0	-	65535	个/0.1L
直流供电电压	4.90	5	5.10	V 伏特
接口电平	2.7	3.3	3.6	V 伏特
最大工作电流	-	-	70	mA 毫安
响应时间	0	1	10	S 秒
工作温度	-10	25	60	℃ 摄氏度
储存温度	-30	25	80	℃ 摄氏度
工作湿度（非水凝）	5%	40%	80%	RH
储存湿度（非水凝）	0%	40%	95%	RH
颗粒物质量浓度一致性（0~100 ug/m3）	-	±10	-	ug/m3 微克/立方米
颗粒物质量浓度一致性（≥100 ug/m3）	-	±10%	-	ug/m3 微克/立方米

地址：东莞市东城街道莞长路东城段53号1栋202室

Add: Room 202, Building 1, No. 53, Dongcheng Section, Guanchang Road, Dongcheng Street, Dongguan

Mobile: 18929273459 / 18922972749

Http: www.forest-electron.com


E-mail: forest_vip@163.com



产品规格书 Product Details Specification

Product Description	Revision	Release Date	Page
FR-23HD5	A 1	2023.08.10	3/5

■ 接口定义

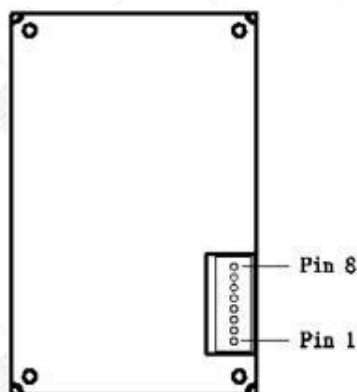

PIN1	VCC	电源 5V
PIN2	GND	电源地
PIN3	NC	NC
PIN4	RXD	串口接收管脚 (3.3V 电平)
PIN5	TXD	串口发送管脚 (3.3V 电平)
PIN6	RESET	使用时悬空。接低会使模块无法工作。
PIN7	NC	NC
PIN8	PWM	PWM 脉宽信号输出管脚 (3.3V 电平)


注意:

- 1、串口输出只需连接PIN1、PIN2、PIN5，其他PIN 脚无须连接。
- 2、PWM 输出只需连接PIN1、PIN2、PIN8，其他PIN 脚无须连接。

■ 通讯接口

UART	默认输出	3.3V 接口电平
PWM	默认输出	3.3V 接口电平

■ 参考电路

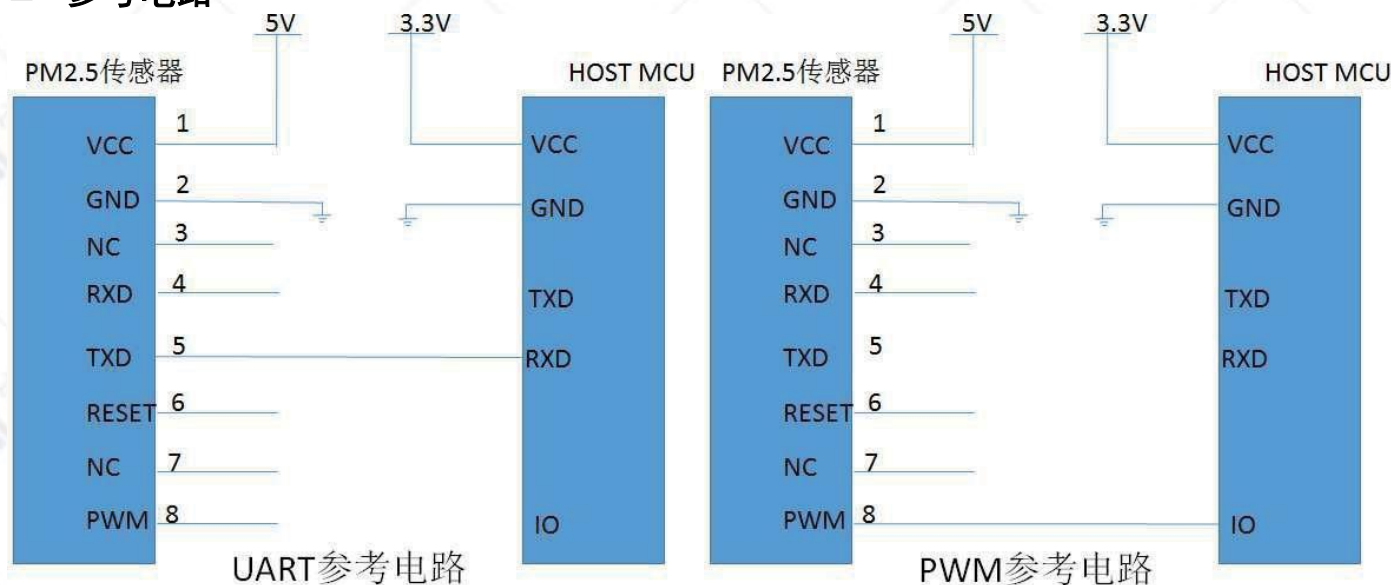

注：UART接口电平3.3V,MCU端如是5V，建议加电平转换，或串200R电阻
MCUTXD此网络，可不接




产品规格书 Product Details Specification


Product Description	Revision	Release Date	Page
FR-23HD5	A 1	2023.08.10	4/5

■ 产品外观尺寸图


单位:mm(± 0.5)

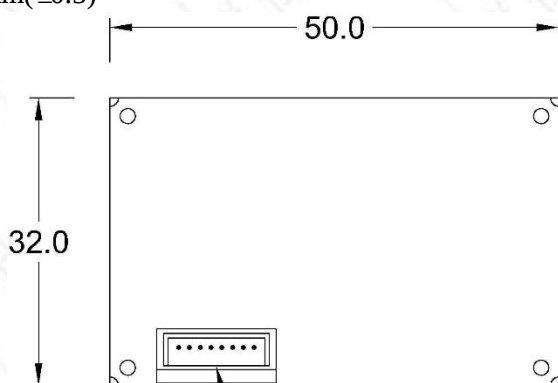

顶视图

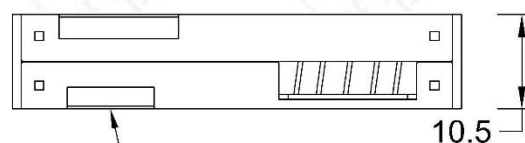

正视图

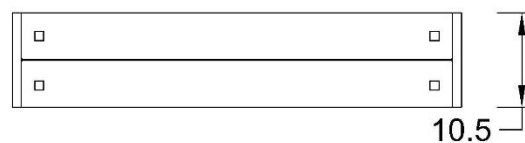

后视图



产品规格书 Product Details Specification

Product Description	Revision	Release Date	Page
FR-23HD5	A 1	2023.08.10	5/5

■ 注意事项 Notes

- 1.金属外壳与传感器内部电源地导通，注意不要和其他外部电路或机箱外壳短接。
- 2.进风口和出风口所在的平面紧贴用户机内壁与外界连通的气孔为最佳安装方式，出风口周围2cm之内无遮挡。进风口和出风口之间应有气流隔离，避免气流在设备内部从出风口直接回流到进风口。
- 3.设备进风口和出风口开孔尺寸不应小于传感器进风口开孔尺寸。
- 4.应用于净化器类产品时，避免将传感器直接置于净化器自身风道，应设计独立结构空间，将传感器置于其中，使其与净化器自身风道隔离。
- 5.传感器安装位置应高于地面15~20CM 以上，否则可能有地面沙尘，飘絮物等大尘埃颗粒甚至絮状物污染导致风扇缠绕阻转，建议使用设备采取适当的预过滤处理。
- 6.用户切勿拆解传感器，包括金属屏蔽壳，以防出现不可逆破坏。
- 7.传感器数据确保出厂个体之间的一致性，不以第三方检测仪器或数据作为对比标准。如用户希望最终测量结果和某第三方检测设备一致，可由用户根据实际采集结果进行数据拟合校准。
- 8.本传感器适用于普通室内环境，如用户设备在以下实际环境中使用,传感器有可能因过度积尘、积油、进水导致数据一致性下降：
 - a)全年尘埃浓度大于300微克/立方米时间超过50%，或大于500微克/立方米时间超过20%.
 - b)油烟环境
 - c)高水雾环境
 - d)户外
- 7.东莞富锐仕公司只承担本产品自身不良问题，对不良品进行退换处理，不承担其它费用责任。
- 8.东莞富锐仕公司的产品验收期为15天。验收期过后视为产品验收合格，东莞富锐仕公司不再接受退货。



产品规格书 Product Details Specification

■ 附页 Appendix

UART 通信协议

串口波特率：9600；校验位：无；停止位：1 位；数据包长度：32 字节（8BIT）

数据格式如下：

起始符 1	0x42	（固定）
起始符 2	0x4d	（固定）
帧长度高八位		帧长度=2×13+2（数据+校验位）
帧长度低八位		
数据 1 高八位		数据 1 表示 PM1.0 浓度(0.3um~1.0um)，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （标准颗粒物）
数据 1 低八位		
数据 2 高八位		数据 2 表示 PM2.5 浓度(0.3um~2.5um)，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （标准颗粒物）
数据 2 低八位		
数据 3 高八位		数据 3 表示 PM10 浓度(0.3um~10um)，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （标准颗粒物）
数据 3 低八位		
数据 4 高八位		数据 4 表示 PM1.0 浓度(0.3um~1.0um)，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （大气环境下）
数据 4 低八位		
数据 5 高八位		数据 5 表示 PM2.5 浓度(0.3um~2.5um)，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （大气环境下）
数据 5 低八位		
数据 6 高八位		数据 6 表示 PM10 浓度(0.3um~10um)，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （大气环境下）
数据 6 低八位		
数据 7 高八位		数据 7 表示 0.1 升空气中直径在 0.3um 以上颗粒物个数
数据 7 低八位		
数据 8 高八位		数据 8 表示 0.1 升空气中直径在 0.5um 以上颗粒物个数
数据 8 低八位		
数据 9 高八位		数据 9 表示 0.1 升空气中直径在 1.0um 以下颗粒物个数
数据 9 低八位		
数据 10 高八位		数据 10 表示 0.1 升空气中直径在 2.5um 以下颗粒物个数
数据 10 低八位		



产品规格书 Product Details Specification

数据 11 高八位		数据 11 表示 0.1 升空气中直径在 5.0um 以上颗粒物个数
数据 11 低八位		
数据 12 高八位		数据 12 表示 0.1 升空气中直径在 10um 以下颗粒物个数
数据 12 低八位		
数据 13 高八位		数据 13 预留
数据 13 低八位		
数据和校验高八位		校验码=（起始符 1+起始符 2+.....+数据 13 低八位）的和
数据和校验低八位		

PWM 通讯（仅供参考）

固定输出周期为 1.005S 的 PWM 信号，PM2.5 浓度与 PWM 低电平的时间成正比 1mS 相当于 1Ug，100ms 相当于 100Ug。

示例：

